



ISO 9001 / JIS Q 9001 : 2000 APPROVED BY BVOI
ISO 9001 認証取得



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

スリムなボディに 凝縮された高機能

NEW

標準価格 6,500円(税込 6,825円)
(携帯用ケース付)

- オーバーモールド採用で手にジャストフィット
- 暗所で値が確認できるLCDバックライトを装備
- 測定目標を明るく照らす、長寿命LEDライトを採用
- 電池の消耗を抑えるオートパワーオフ
- 測定コードを本体裏側へスマートに収納可能
- 安全規格
IEC 61010-1 : 2001
CAT.Ⅲ 600V に準拠



キューマルチメータ


KEW 1030

共立電気計器株式会社

● KEW 1030 仕様

測定項目	交流電圧	4/40/400/600V(4レンジ・オート) ±1.3%rdg±5dgt(4/40V)(50/60Hz) ±1.6%rdg±5dgt(400/600V)(50/60Hz)
	直流電圧	400mV/4/40/400/600V(5レンジ・オート) ±0.8%rdg±5dgt(400mV~400V) ±1.0%rdg±5dgt(600V)
	抵抗	400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ(6レンジ・オート) ±1.0%rdg±5dgt(400Ω~4MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40MΩ)
	ダイオード	試験電圧 約0.3~1.5V
	導通チェック	120Ω以下でブザー音
	容量	50n/500n/5μ/50μ/100μF(5レンジ・オート) ±3.5%rdg±10dgt(50nF) ±3.5%rdg±5dgt(500n~50μF) ±4.5%rdg±5dgt(100μF)
	周波数	5/50/500Hz/5/50/200kHz ±0.1%rdg±5dgt(測定可能入力:1.5Vrms以上)
	DUTY	0.1~99.9% ±2.5%rdg±5dgt(パルス幅/パルス周期)
	データホールド	データホールドボタンをONで動作
	電池残量警告	約2.4V以下で警告表示
一般仕様	オートパワーオフ	電源投入後無操作約30分でパワーオフ
	適応規格	IEC61010-1 CAT.Ⅲ 600V 汚染度2 IEC61010-031 EMC:IEC61326
	使用電池	アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2
	外形寸法	190(L)×39(W)×31(D)mm
	重量	約100g(電池含む)
	付属品	携帯用ケース アルカリボタン電池LR44(1.5V)×2 取扱説明書


● 各部の名称

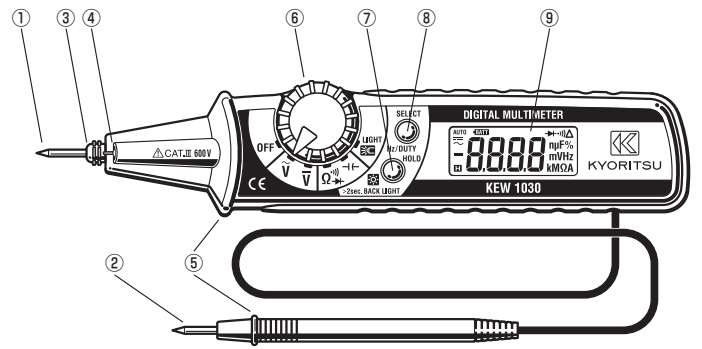

- ①本体テストピン (+入力端子; 赤)
- ②テストリード (-入力端子; 黒)
測定時に回路の一侧又はアース側に使用します
- ③安全カバー
持ち運ぶときや使用しないときには安全カバーをすることができます。
- ④LEDライト ⑤パリア ⑥ファンクションスイッチ
- ⑦ホールド(HOLD)キー ⑧セレクト(SELECT)キー ⑨LCD表示

使いやすいさを追求した機能


■ 暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDライト

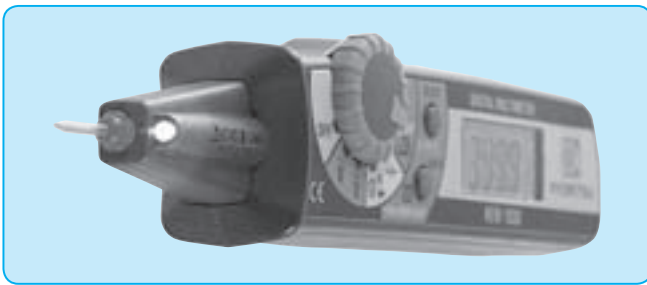

■ 不意の事故を防止する安全カバー



■ 測定コードをスマートに本体裏側へ収納可能

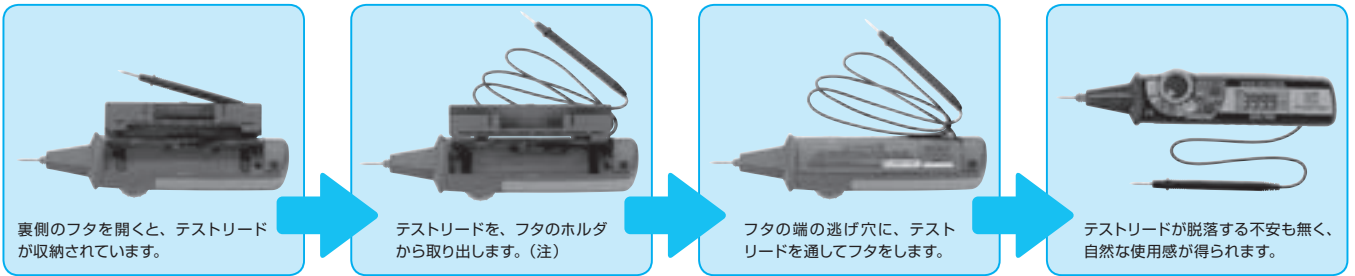

注: テストリードは引き出し長さを3段階(約60/40/20cm)に調節可能です。



安全にお使いいただくために

ご使用前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

本社 東京営業所 産機直需課	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
大阪営業所	〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 江坂三昌ビル 6F ☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590
仙台営業所	〒983-0841 仙台市宮城野区原町 1-3-21-308号 ☎ 022(297)9671 FAX. 022(298)8009
サービスセンター	〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480 ☎ 0894(62)1171 FAX. 0894(62)5531
工場	宇和島・愛媛

<http://www.kew-ltd.co.jp>



この印刷物は環境保護のため、大豆油インクと再生紙を使用しています。

●このリーフレット記載内容は断りなく変更する場合があります。 05.03AD